



GENU-TEX® SPORLASTIC

Dynamische Textile Knieorthese mit polyzentrischen Gelenken

Dynamic textile knee brace with polycentric joints

Orthèse textile du genou dynamique avec articulations polycentriques

Rodillera ortopédica textil dinámica con articulaciones policéntricas

Ortesi tessile dinamica per ginocchia con articolazioni policentriche

Dynamische knieorthese van textiel met polycentrische gewrichten

Dynamiczna tekstylna orteka kolanowa z wielooosiowymi przegubami

KONTROLIERTE BEWEGUNGSLIMITIERUNG

Extension

- 0° Schraube
- 5° Schraube und weißer Ring
- 10° Schraube und grüner Ring

Flexion

- 20° Schraube und grüner Ring
- 30° Schraube und weißer Ring
- 50° Schraube und grüner Ring
- 60° Schraube
- 85° Schraube und weißer Ring
- 90° Schraube

CONTROLLED MOVEMENT LIMITATION

Extension

- Flexion
- 0° screw and green ring
- 5° screw and white ring
- 10° screw and green ring
- 20° screw
- 30° screw and green ring
- 50° screw
- 60° screw
- 85° screw and white ring
- 90° screw

LIMITATION CONTRÔLÉE DES MOUVEMENTS

Extension

- Flexion
- 0° Vis
- 5° Vis et anneau vert
- 10° Vis et anneau blanc
- 20° Vis et anneau vert
- 30° Vis et anneau blanc
- 50° Vis et anneau vert
- 60° Vis
- 85° Vis et anneau blanc
- 90° Vis

LIMITACIÓN CONTROLADA DE MOVIMIENTOS

Extensión

- Flexión
- Tornillo 0°
- Tornillo 5° y anillo blanco
- Tornillo 10° y anillo verde
- Tornillo 20° y anillo verde
- Tornillo 30° y anillo blanco
- Tornillo 50° y anillo verde
- Tornillo 60°
- Tornillo 85° y anillo blanco
- Tornillo 90°

LIMITAZIONE CONTROLLATA DEI MOVIMENTI

Estensione

- Flessione
- 0° vite
- 5° vite e rondella bianca
- 10° vite e rondella verde
- 20° vite e rondella verde
- 30° vite e rondella bianca
- 50° vite e rondella verde
- 60° vite
- 85° vite e rondella bianca
- 90° vite

GECONTROLEERDE BEWEGINGSBEPERKING

Distractie

- Buiging
- 0° Schroef
- 5° Schroef en witte ring
- 10° Schroef en groene ring
- 20° Schroef en groene ring
- 30° Schroef en witte ring
- 50° Schroef en groene ring
- 60° Schroef
- 85° Schroef en witte ring
- 90° Schroef

KONTROLLOWANE OGRODZENIE RUCHU

Ograniczenie ekstensyjne

- Ograniczenie fleksyjne
- 0° śrubka
- 5° śrubka i biały pierścień
- 10° śrubka i zielony pierścień
- 20° śrubka i zielony pierścień
- 30° śrubka i biały pierścień
- 50° śrubka i zielony pierścień
- 60° śrubka
- 85° śrubka i biały pierścień
- 90° śrubka

1

2



GEBRAUCHSANWEISUNG D

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
wir bitten Sie, die beiliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig zu beachten. Bei auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an den behandelnden Arzt, an Ihr nächstliegendes Fachgeschäft oder direkt an uns.

FUNKTION

GENU-TEX® verbindet die positiven Eigenschaften von Hartharmonorthese und Bandage. Propriozeptive Reize aktivieren die Muskelarbeit. Das Kniegelenk wird stabilisiert und geführt.

Vom Orthopädietechniker kann GENU-TEX® individuell angepasst werden und die Kniebewegung lässt sich kontrolliert limitieren. Die dynamische Orthese ist leicht anzulegen und sehr angenehm zu tragen. Sie eignet sich besonders für den Einsatz im geriatrischen Bereich sowie zum Sport. Die hochwertigen polyzentrischen Gelenke sind von welchem Textil komplett umkleidet.

TRÄGEKOMFORT

Sollte der Patient auf Druckstellen im Bereich der Gelenkschienen hinweisen, können diese wie in Abb. 6 gezeigt, aus der GENU-TEX® herausgenommen und mit Rundschärpen an die individuellen anatomischen Gegebenheiten des Patienten angepasst werden.

INDIKATIONEN

Die Kombination aus elastischem Gestrick und unelastischem semi-zirkulären Gurtssystem ermöglicht eine optimale Anpassung an die individuelle, anatomische Situation des Patienten.

WICHTIGE HINWEISE:

Das Produkt ist zur Versorgung für einen Patienten bestimmt.

Die erstmalige Anpassung der GENU-TEX® darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen, ansonsten ist eine Produkthaftung nicht gewährleistet.

Nicht fachgerechte Veränderungen am Produkt und/oder nicht zweckbestimmte Verwendung des oben angeführten Produktes schließen eine Produkthaftung des Herstellers aus.

Bitte schließen Sie bei Rücksendungen die Klettverschlüsse ordnungsgemäß.

Mögliche gesundheitliche wechselseitige Risiken oder sonstige Nachteile bei bestimmten Behandlungen, die sich im Zusammenhang mit der Verwendung des Produktes ergeben können, sind mit dem behandelnden Arzt abzusprechen.

Damit das Produkt eine lange Lebensdauer und Funktion bietet, darf es nicht im Zusammenhang mit fet- und säurehaltigen Mitteln, Salben oder Lotions getragen werden.

Das Produkt kann über den Haussmüll entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen.

Die SPORLASTIC GmbH ist einem Rücknahmesystem für Verpackungen angeschlossen und kommt somit den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden verpackungsrechtlichen Bestimmungen vollständig nach.

Bitte führen Sie die Verpackung dem örtlichen Wertstoff-Sammelsystem zu.

QUALITÄTSMANAGEMENT-SYSTEM

Alle Produkte der SPORLASTIC GmbH unterliegen der Produktprüfung innerhalb unsrer Qualitätsmanagementsystems. Sollten Sie dennoch Beanstandungen an unserem Produkt haben, bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachgeschäft oder direkt mit uns in Verbindung zu setzen.

Für unsere Produkte gewähren wir Garantie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.


PFLEGE

Wir empfehlen, GENU-TEX® schonend in handwarmem Wasser mit Feinwaschmittel zu waschen, an der Luft zu trocknen und nicht auf den Heizkörper zu legen.

Zum Waschen von GENU-TEX® entfernen Sie bitte die beiden Verstärkungsschienen aus der Orthese. Schließen Sie die Klettverschlüsse vor dem Waschen. Damit bleiben die Klettverschlüsse länger funktionsfähig.

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

67% Polyamid, 33% Elasthan

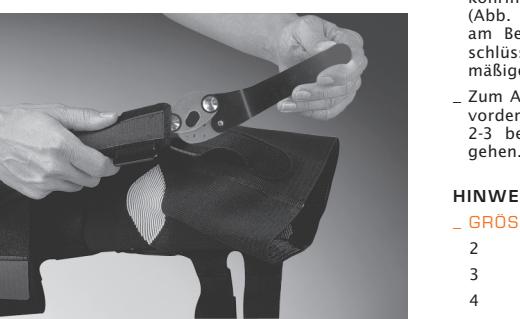

5	bis 40 cm	bis 50 cm
6	bis 43 cm	bis 53 cm

Umfang d = 14 cm von Kniemitte nach unten.
Umfang f = 14 cm von Kniemitte nach oben.

ACHTUNG: GENU-TEX® Knieorthese wird mit 5° Extensions-Stop ausgeliefert.

Kontrollierte Bewegungslimitierung:

Flexion und Extension werden mit den beiliegenden weißen und grünen Kunststoffringen und der Feststellschraube eingestellt. Die Einstellungen lesen Sie bitte an der Grafik „Kontrollierte Bewegungslimitierung“ ab. Die Gradeinstellungen sollte nach Anordnung des Arztes erfolgen.

Druckstellen im Bereich der Gelenkschienen:

Sollte der Patient auf Druckstellen im Bereich der Gelenkschienen hinweisen, können diese wie in Abb. 6 gezeigt, aus der GENU-TEX® herausgenommen und mit Rundschärpen an die individuellen anatomischen Gegebenheiten des Patienten angepasst werden.

CONTRA-INDICATIONS

Higher-grade axis deviation > approx. 15°

Peripheral arterial occlusive disease with popliteal arterial occlusion and bypass revascularisation or marginal peripheral circulation reserve, vascular compression risk

Improper modifications to the product and/or improper use of the product referred to above exempt the manufacturer from product liability.

You ought to discuss potential reciprocal health risks or other disadvantages with specific treatments that may arise in connection with the use of the product with the doctor treating you.

For the product to work effectively over a long period, it must not be worn in conjunction with fatty or acidic remedies, ointments or lotions.

The product is to be used by one patient only.

The very first time the GENU-TEX® is adjusted this must be done by trained technical staff, otherwise no product liability is warranted.

Improper modifications to the product referred to above exempt the manufacturer from product liability.

Les apparitions locales de pression et les troubles de la circulation peuvent être évités individuellement si l'on tient compte d'éventuelles contreindications et d'un positionnement sur le corps sans contrainte et adapté aux formes du corps.

Pour enlever GENU-TEX®, il vaut mieux s'asseoir sur une chaise de sorte que le genou se trouve en position pliée.

Après avoir ouvert toutes les fermetures velcro, prenez GENU-TEX® à deux mains aux boucles, en placant le tissu du creux du genou en votre direction. Puis enflez GENU-TEX® de l'articulation de la cheville jusqu'à ce que le creux du genou (Fig. 1).

Ensuite tournez GENU-TEX® sur le bas de la jambe de 180°.

Le tissu du creux du genou dirige alors en direction du mollet (Fig. 2).

Enfilez alors GENU-TEX® sur le genou jusqu'à ce que l'anneau en silicone enveloppe la rotule (Fig. 3).

Fermez à présent les fermetures velcro en vous conformant à l'ordre chronologique numéroté sur la Fig. 4 en effectuant une légère traction (du bas vers le haut).

En position debout, veuillez une fois encore vérifier si l'anneau de silicone enveloppe encore bien la rotule (Fig. 5). Ce cas échéant ajustez GENU-TEX® à la jambe et resserrez toutes les fermetures velcro de sorte que les 8 sangles de fixation exercent la même pression sur la jambe (Fig. 5).

Pour enlever GENU-TEX®, il suffit le plus souvent d'ouvrir les fermetures velcro avant et de procéder dans l'ordre chronologique inverse décrit aux points 2 à 3.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

All SPORLASTIC GmbH products undergo product testing as part of our Quality Management System.

However, should you have any complaints about our product, please get in touch with your stockist or directly with us.

CARE

Wash GENU-TEX® in lukewarm water with a cold-water detergent and air dry. Do not place on a radiator. The enclosed heel pad can be cleaned with a moist cloth.

When washing the GENU-TEX® please remove the two splints from the brace. Close the Velcro fasteners before washing. The Velcro fasteners will then last longer.

SIDE-EFFECTS

With proper use and proper fitting, so far there have been no reports of serious general side-effects.

Local pressure symptoms and impaired circulation can be prevented with sufficient certainty on an individual basis if allowance is made for any contraindications and with non-restricting consistently shaped body fitting.

So far no consequential incompatibilities or allergic reactions have been reported.

SIDE-EFFECTS

With proper use and proper fitting, so far there have been no reports of serious general side-effects.

Local pressure symptoms and impaired circulation can be prevented with sufficient certainty on an individual basis if allowance is made for any contraindications and with non-restricting consistently shaped body fitting.

So far no consequential incompatibilities or allergic reactions have been reported.

FITTING

To fit the GENU-TEX®, it is better for you to sit on a chair so that your knee is slightly flexed.

After opening all the Velcro fasteners, grasp the GENU-TEX® with both hands holding the integrated pull straps with the popliteal stitching showing. Then pull the GENU-TEX® over your knee until it is below the popliteal cavity (Fig. 1).

Then turn the GENU-TEX® 180° at the lower leg. The popliteal stitching shows at the calf (Fig. 2).

Next, pull the GENU-TEX® over your knee until the silicone ring encloses the kneecap well (Fig. 3).

Now close the Velcro fasteners (upwards) as numbered in Fig. 4 with slight tension.

Stand up and check again whether the silicone ring still encloses the kneecap well (Fig. 5). If necessary, re-adjust the GENU-TEX® to your leg and then pull all the Velcro fasteners in such a way that all 8 fastening straps fit the leg well with even traction (Fig. 5).

To remove the GENU-TEX®, generally all you have to do is just open the front Velcro fasteners and proceed as described in 2-3 above in the reverse order.

INSTRUCTIONS FOR THE ORTHOPAEDICS TECH

soumis au contrôle produit au sein de notre Système de Gestion de la Qualité.
Si vous aviez néanmoins quelques réclamations concernant notre produit, veuillez nous adresser à votre magasin spécialisé ou directement à nous.

ENTRETIEN

Nous conseillons de laver en douceur GENU-TEX® dans de l'eau tiède avec un produit de lavage à froid, de le laisser sécher à l'air et de ne pas le poser sur le radiateur.
Pour laver GENU-TEX®, veuillez sortir les deux attelles de renforcement de l'orthèse. Fermez les fermetures agrippantes avant le lavage, elles conserveront ainsi plus longtemps leur bon état de fonctionnement.

COMPOSITION

67% Polyamide, 33% Spandex

INSTRUCCIONES DE USO E

Estimado/a cliente

Le rogamos que observe atentamente las instrucciones de uso adjuntas. En caso de duda, le rogamos se dirija al médico que le trata, al comercio especializado que tenga más a mano o directamente a nosotros.

FUNCIÓN

GENU-TEX® combina las propiedades positivas de prótesis ortopédicas de marco rígido y bandajes. Estímulos proprioceptivos activan el trabajo muscular. La articulación de la rodilla se estabiliza y guía.
GENU-TEX® puede ser adaptado individualmente por el técnico ortopédico y el movimiento de la rodilla puede limitarse de forma controlada. La prótesis ortopédica dinámica es fácil de aplicar y muy agradable de llevar. Esta se adapta especialmente para su aplicación en el ámbito geriátrico así como en el deporte. Las articulaciones policéntricas de alta calidad están envueltas completamente por tejidos suaves.

INDICACIONES

- ACL/Ruptura
- Lesión del ligamento lateral
- Reconstrucción del menisco
- Gonartrosis
- Artritis reumatoide
- Aflojamiento TEP de la rodilla
- Inestabilidad monoaxial o poliaxial

CONTRAINDICACIONES

Desviación axial de mayor grado > aprox. 15°
AVK periférica con oclusión arterial popliteal y revascularización del bypass o reserva de circulación periférica marginal, riesgo de compresión vascular

En general las indicaciones y modo de empleo de los medios auxiliares ortopédicos así como, en particular, siempre que se den casos de padecimientos ulteriores, deben consultarse con el médico:

- Modificaciones de la piel por causa de alergias, hinchazones o heridas (por ejemplo, tumefacciones e inflamaciones) de la zona del cuerpo a tratar.
- Hinchazones de tejidos blandos linfáticos o que afecten a la irrigación sanguínea.
- Perturbaciones relacionadas al sistema nervioso del sistema sensorial y dermatológico de la zona del cuerpo a tratar (per turbaciones de la sensibilidad con o sin daños dérmicos).

Hasta hoy no se conocen intolerancias perjudiciales o reacciones alérgicas.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Con un uso adecuado y una colocación correcta no se conocen hasta hoy efectos secundarios generales graves. Ciertamente pueden evitarse suficientemente los fenómenos de presión locales y las reducciones de la circulación sanguínea, si se observan en cada caso las correspondientes contraindicaciones y no se adoptan posturas com presoras y forzadas.

COLOCACIÓN

- Para colocarse la rodillera GENU-TEX®, siéntese mejoras conveniente sentarse en una silla, de tal modo que la rodilla tenga una ligera flexión.
- Después de haber abierto todos los cierres de velcro, coja la GENU-TEX® con ambas manos por los respectivos lazos, mirando sobre el tejido de la corva. A continuación, deslice Luego corra la GENU-TEX® por la articulación tibiotarsiana hasta por debajo de la corva (Fig. 1).

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

67% poliamida, 33% elastano

— Gire entonces la GENU-TEX® en la pierna 180°. El tejido de la corva indica hacia la pantorrilla (Fig. 2).

— Corra luego deslice seguidamente la GENU-TEX® por encima de la rodilla hasta que el anillo de silicona rodee la rótula (Fig. 3).

— Asegure ahora los cierres de velcro tirando ligeramente de ellos como se ha enumerado en la Fig. 4 (de abajo hacia arriba).

— Levántese Párese y compruebe otra vez por favor si el anillo de silicona sigue rodeando bien la rótula (Fig. 5). Si es necesario, readuje la GENU-TEX® en la pierna y apriete entonces todos los cierres de velcro de tal modo que todas las 8 correas de fijación se ciñan bien a la pierna con una tracción uniforme (Fig. 5).

— Para sacarse la GENU-TEX®, basta por lo general con abrir sólo los cierres de velcro delanteros y proceder en orden inverso a como se ha descrito describir en los puntos 2 y 3.

INDICACIONES PARA EL TÉCNICO ORTOPÉDICO:

TAMANOS	Medida d	Medida f
2	hasta 31 cm	hasta 41 cm
3	hasta 34 cm	hasta 44 cm
4	hasta 37 cm	hasta 47 cm
5	hasta 40 cm	hasta 50 cm
6	hasta 43 cm	hasta 53 cm

Perímetro d = 14 cm del centro de la rodilla hacia abajo. Perímetro f = 14 cm del centro del ginocchio hacia arriba.

ATENCIÓN: La rodillera ortopédica GENU-TEX® se entregará con un tipo de extensión de 5°.

LIMITACIÓN controlada de movimientos:

Los diversos ajustes de los grados para la flexión y la extensión se efectúan utilizando un anillo de plástico blanco o verde adjuntado adicionalmente o, así como exclusivamente con la ayuda de tornillo fijador. Lea por favor los ajustes del gráfico „Limitación controlada de movimientos“. El uso los ajustes de los grados debería tener lugar según la prescripción del médico. Será el facultativo quien determine el uso de los ajustes de los grados.

PUNTOS DE PRESIÓN EN LA ZONA DE LAS TABILLAS ARTICULADAS:

Si el paciente llama la atención experimenta por puntos de presión en la zona de las tabillas articuladas, éstas pueden ser extraídas de la GENU-TEX® como se indica en la Fig. 6 y reconformadas con un triscador redondo para adaptarlas a las condiciones anatómicas individuales del paciente.

CONFORT DE USO

La combinación de tejido elástico y un sistema de correas semicírcular inelástico permite una óptima adaptación a la situación anatómica individual del paciente.

INDICACIONES IMPORTANTES

Este producto está destinado a un uso único por el paciente.

La primera adaptación de la rodillera GENU-TEX® deberá ser efectuada sólo por un personal técnico capacitado, dde lo contrario, no se garantiza una responsabilidad por el producto.

Las modificaciones indebidas del producto y/o el uso distinto para el que el producto arriba citado está destinado eximen al fabricante de cualquier responsabilidad.

Los posibles riesgos para la salud o cualquier daño en determinados tratamientos que pudieran producirse en relación con el uso de este producto deben ser consultados con el médico del tratamiento.

A fin de que este producto tenga una larga vida y funcionalidad, no debe ponerse en contacto con materias grasas y ácidas, pomadas o lociones.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

Todos los productos SPORLASTIC GmbH se someten a la inspección de productos dentro de nuestro sistema de control de calidad.

Si, no obstante, tuviera alguna queja que formular acerca de nuestro producto, le rogamos se ponga en contacto con su comercio especializado o directamente con nosotros.

CUIDADO

Recomendamos lavar cuidadosamente el GENU-TEX® en agua tibia con Detergente para agua fría en frío, secarlo al aire y no colocarlo sobre el radiador.

Las almohadillas para el talón adjuntas abiertas pueden ser limpiadas con un paño húmedo. Para lavar GENU-TEX®, retire ambas férulas de refuerzo de la prótesis ortopédica. Cierre las bandas de velcro antes de lavar. Con ello, los cierres de velcro tendrán una funcionalidad más duradera.

COMPOSICIÓN DEL MATERIAL

67% poliamida, 33% elastano

ISTRUZIONI PER L'USO |

Egregio cliente, egregio cliente,
si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e di attenersi precisamente alle indicazioni in esse riportate.

Nel caso di eventuali domande non esitate a consultare il Vostro medico di fiducia oppure il Vostro rivenditore specializzato più vicino o direttamente il nostro servizio di consulenza.

FUNZIONE

GENU-TEX® coniuga le caratteristiche positive di un'ortesi rigida e di un tutore. Stimoli proprioettivi attivano il lavoro muscolare. Il ginocchio viene stabilizzato e guidato.

GENU-TEX® può essere adattata individualmente dal tecnico ortopedico e il movimento del ginocchio può essere limitato in maniera controllata. L'ortesi dinamica è facile da indossare ed è molto comoda da portare. È particolarmente adatta all'impiego in campo geriatrico e per lo sport. Le articolazioni policentriche di qualità elevata sono completamente rivestite con morbido tessuto.

INDICAZIONI

- Rottura ACL
- Lesione del legamento laterale
- Ricostruzione del menisco
- Gonartrosi
- Artrite reumatica
- Allentamiento della EPT del ginocchio
- Instabilità su uno o più assi

CONTROINDICAZIONI

- Elevato grado di deviazione assiale > ca. 15°
- PAOD (patologia oclusiva delle arterie periferiche) con occlusione po' pliteale delle arterie e rivascolarizzazioni con bypass, cioè limitata riser va di vascolarizzazione, rischio di compressione vascolare.

In linea di massima l'indicazione e la modalità di indossare un mezzo auxiliare ortopedico nonché nella presenza di successivi stati patologici dovrebbe essere sempre concordata e prescritta da un medico di fiducia:

— Cambiamenti cutanei dovuti ad allergie, infiammazioni oppure lesio ni (per esempio tumefazione, arrossamento) delle regioni corporee da curare.

— Circolazioni sanguigne pregiudicate o tumefazioni linfatiche delle parti molli.

— Disfunzioni neurogena condizionate degli organi sensoriali e trofica cutanea nella regione corporea da curare (disfunzioni sensoriali con o senza danni cutanei).

Finora non sono diventate note alcune complicazioni in seguito a conseguenti situazioni di incompatibilità o reazioni allergiche.

EFFETTI COLLATERALI

In un'applicazione ed impiego appropriati non sono diventati noti altri effetti collaterali rilevanti in genere.

Le pressioni locali appariscenti e la circolazione sanguigna pregiudicata possono essere evitati sufficientemente con sicurezza nella considerazione di eventuali controindicazioni ed in un'applicazione non troppo stretta, accompagnata ed individualmente adattata.

APPLICAZIONE

— Per applicare la GENU-TEX® si consiglia di sedersi su una sedia, in modo da poter leggermente piegare il ginocchio.

— Dopo aver aperto le varie chiusure a velcro, afferrare con ambedue le mani la GENU-TEX® dai tiranti ad essa applicati, facendo attenzione al tessuto per la poplitea. Dopo qualche momento far passare la GENU-TEX® sopra l'articolazione tibio-tarsale fino a sotto la poplitea (Fig. 1).

— Girare successivamente di 180° la GENU-TEX® sulla gamba, finché il tessuto per la poplitea non è rivolto verso il polpaccio (Fig. 2).

— Dopodiché fare passare la GENU-TEX® sopra il ginocchio, finché l'anello di silicone avvolge completamente la rotula (Fig. 3).

— Chiudere a questo punto le chiusure a velcro, stringendole leggermente e seguendo la numerazione dell'illustrazione 4 (dal basso verso l'alto).

— Controllare nuovamente, stando in piedi, se l'anello di silicone avvolge ancora completamente la rotula (Fig. 5).

Eseguire eventualmente un riaggiustamento della GENU-TEX® rispetto alla gamba e stringere quindi le varie chiusure a velcro, in maniera tale da fare combaciare omogeneamente alla gamba tutte le 8 cinture di fissaggio (Fig. 5).

— Nella maggior parte dei casi per staccare la GENU-TEX® è sufficiente aprire soltanto le chiusure a velcro anteriori e procedere quindi come descritto ai punti 2-3, tuttavia, le cinture di velcro dovranno essere tirate.

COMPOSIZIONE DEL MATERIALE

67% poliamide, 33% elastano

INFORMAZIONI PER IL TECNICO ORTOPEDICO:

TAGLIE	Misura d	Misura f
2	fino a 31 cm	fino a 41 cm
3	fino a 34 cm	fino a 44 cm
4	fino a 37 cm	fino a 47 cm
5	fino a 40 cm	fino a 50 cm
6	fino a 43 cm	fino a 53 cm

Circonferenza d = 14 cm dal centro del ginocchio verso il basso.

Circonferenza f = 14 cm dal centro del ginocchio verso l'alto.

ATTENZIONE: l'ortesi per ginocchia GENU-TEX® viene fornita con un arresto d'estensione di 5°.

— Asegure ahora los cierres de velcro tirando ligeramente de ellos como se ha enumerado en la Fig. 4 (de abajo hacia arriba).

— Levántese Párese y compruebe otra vez por favor si el anillo de silicona sigue rodeando bien la rótula (Fig. 5).

— Asegure ahora los cierres de velcro tirando ligeramente de ellos como se ha enumerado en la Fig. 4 (de abajo hacia arriba).

— Levántese Párese y compruebe otra vez por favor si el anillo de silicona sigue rodeando bien la rótula (Fig. 5).

— Asegure ahora los cierres de velcro tirando ligeramente de ellos como se ha enumerado en la Fig. 4 (de abajo hacia arriba).

— Levántese Párese y compruebe otra vez por favor si el anillo de silicona sigue rodeando bien la rótula (Fig. 5).

— Asegure ahora los cierres de velcro tirando ligeramente de ellos como se ha enumerado en la Fig. 4 (de abajo hacia arriba).

— Levántese Párese y compruebe otra vez por favor si el anillo de silicona sigue rodeando bien la rótula (Fig. 5).

— Asegure ahora los cierres de velcro tirando ligeramente de ellos como se ha enumerado en la Fig. 4 (de abajo hacia arriba).

— Levántese Párese y compruebe otra vez por favor si el anillo de silicona sigue rodeando bien la rótula (Fig. 5).

— Asegure ahora los cierres de velcro tirando ligeramente de ellos como se ha enumerado en la Fig. 4 (de abajo hacia arriba).